

Konin, 07.04.2025r.

WSZ-EP-63/24/244/2025

**Wszyscy Wykonawcy ubiegający się o udzielenie Zamówienia publicznego/
strona internetowa prowadzonego postępowania****Odpowiedź na zapytania w sprawie SWZ**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości równej lub przekraczającej progi unijne, na zadanie pod nazwą: „Dostawa obłożeń i bielizny operacyjnej” (nr sprawy: WSZ-EP-63/2024).

Zamawiający informuje, iż do ww. postępowania zostały złożone zapytania. W związku z powyższym działając na podstawie art. 135 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320), zwanej dalej „Ustawą Pzp.”, Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

PAKIET 6 Czy Zamawiający dopuści fartuchy nieznacznie różniące się od opisu Zamawiającego: Sterylny pełnoochronny fartuch chirurgiczny, wykonany z włókniny typu SMS, z nieprzemakalnymi wstawkami w przedniej części i w rękawach chronią operatora przed przenikaniem płynów, u góry zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym, mankietem, dł. min 6 cm troki łączone kartonikiem, sposób złożenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, kolor niebieski fartuch powinien być z dodatkowymi dwoma ściereczkami do wytarcia rąk oraz zawinięciem np. w serwetę włókninową lub papier, jako zabezpieczenie przed przypadkowym zbrudzeniem, rozmiar XL. **Włóknina 5-warstwowa SMMMS** o gramaturze nie mniejszej niż 35g/m²; nieprzemakalność w strefie krytycznej min, 55cmH₂O; Wytrzymałość na rozerwanie min.(sucho/mokro)149/125 Kpa ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. W związku z tym Zamawiający zmienia zapisy Załącznika nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy w pakiecie nr 6.

Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.

PAKIET 6 Czy Zamawiający dopuści fartuchy nieznacznie różniące się od opisu Zamawiającego: Sterylny pełnoochronny fartuch chirurgiczny, wykonany z włókniny typu SMMMS, z nieprzemakalnymi wstawkami w przedniej części i w rękawach chronią operatora przed przenikaniem płynów, u góry zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym, mankietem, dł. min 7cm troki łączone kartonikiem, sposób złożenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, fartuch powinien być z dodatkowymi dwoma ściereczkami o wym. 30 x 40 cm do wytarcia rąk. Fartuch zawinięty w **serwetę włókninową lub papier krepowy** o wym. 60 x 60 cm, jako zabezpieczenie przed przypadkowym zbrudzeniem.

Włóknina 5-warstwowa typu SMMMS o gramaturze min. 35g/m² + wzmocnienie wewnętrzne w przedniej części i w rękawach o gramaturze min. 40 g/m²,

- odporność na przesiąkanie płynów w obszarze krytycznym min 49,5cm H₂O;
- wytrzymałość na rozciąganie w obszarze krytycznym min.(sucho/mokro) 105/100 N
- Wytrzymałość na wypychanie – na sucho: dla obu stref > 145 kPa

- Wytrzymałość na wypychanie – na mokro: dla strefy krytycznej > 135 kPa?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

PAKIET 7 Czy Zamawiający dopuści fartuchy nieznacznie różniące się od opisu Zamawiającego:

Sterylny pełnoochronny fartuch chirurgiczny, wykonany z włókniny typu SMMMS, u góry zapinany na rzep, rękawy zakończone elastycznym, mankietem, dł min. 7 cm troki łączone kartonikiem tak aby umożliwić sterylne założenie sposób złożenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, kolor niebieski, fartuch powinien być z dodatkowymi dwoma ściereczkami o wym. 30 x 40 cm do wytarcia rąk. Fartuch zawinięty w **serwetę włókninową lub papier krepowy** o wym. 60 x 60 cm, jako zabezpieczenie przed przypadkowym zbrudzeniem. Włóknina 5-warstwowa typu SMMMS o gramaturze min. 35g/m²;

- odporność na przesiąkanie płynów w obszarze krytycznym min 49,5cm H₂O;

- wytrzymałość na rozciąganie min.(sucho/mokro) 95/90 N

- wytrzymałość na wypychanie – na sucho: dla obu stref > 135 kPa

- wytrzymałość na wypychanie – na mokro: dla strefy krytycznej > 125 kPa

Rozmiar L * W strefie krytycznej zgodność z normą PN -EN 13795; 3 lub równoważne?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. W związku z tym Zamawiający zmienia zapisy Załącznika nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy w pakiecie nr 7.

Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.

PAKIET 8 Czy Zamawiający dopuści fartuchy nieznacznie różniące się od opisu Zamawiającego:

Sterylny pełnoochronny fartuch chirurgiczny, wykonany z włókniny typu SMS, u góry zapinany na rzep, rękawy zakończone elastycznym, mankietem, dł min 6 cm troki łączone kartonikiem tak aby umożliwić sterylne założenie sposób złożenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, kolor niebieski, fartuch powinien być z dodatkowymi dwoma ściereczkami do wytarcia rąk ,oraz zawinięciem w papier krepowy biały, jako zabezpieczeniem przed przypadkowym zbrudzeniem, **Włóknina 5-warstwowa SMMMS** o gramaturze 35g/m² do 45g/m²; nieprzemakalność w strefie krytycznej min 31cmH₂O;

Wytrzymałość na rozerwanie min.(sucho/mokro)149/125 Kpa

- Wytrzymałość na wypychanie – na sucho : dla obu stref > 115 kPa

- Wytrzymałość na wypychanie – na mokro : dla strefy krytycznej > 115 kPa rozmiar XL

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. W związku z tym Zamawiający zmienia zapisy Załącznika nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy w pakiecie nr 8.

Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.

PAKIET 13 Czy Zamawiający dopuści osłonę Mayo z poniższymi parametrami:

Sterylna osłona na stolik Mayo wykonana z mocnej foli o grubości min 50 mikronów z dodatkową zewnętrzną warstwą chłonną w górnej części (pod narzędzia) o gramaturze min 27 g/m² o wymiarach min 65x 85 cm - rozmiar całkowity – 79-80cmx145cm. Odporność na penetrację płynów >150cmH₂O, wytrzymałość na rozerwanie na suchu >= 120 kPa?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. W związku z tym Zamawiający zmienia zapisy Załącznika nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy w pakiecie nr 13.

Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.

PAKIET 14 Czy Zamawiający dopuści zarękawek z poniższym opisem:

Zarękawek chirurgiczny z dwuwarstwowego nieprzemakalnego chłonnego laminatu z elastycznym ściągaczem, górna część zarękawka zakończona delikatną gumką opinającą rękę, sterylny, gramatura min. 60g/m². Odporność na przenikanie cieczy min. 100cmH₂O--135cmH₂O. Wytrzymałość na wypychanie na mokro/sucho min. 132/83kPa?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. W związku z tym Zamawiający zmienia zapisy Załącznika nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy w pakiecie nr 14.

Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.

PAKIET 15 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści taśmę lepną OP wykonaną z włókniny spunalce o gramaturze 70 g/m² i papieru silikonowego 90 g/m²?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

PAKIET 15 poz. 2 Czy Zamawiający dopuści osłonę na kończynę w rozmiarze 35x80 cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

PAKIET 15 poz. 2 Czy Zamawiający dopuści osłonę na kończynę wykonaną z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o gramaturze 60 g/m², odporność na przenikanie cieczy min. 135 cm H₂O, wytrzymałość na wypychanie na sucho/mokro min. 131/ 112 kPa, pakowany w zestawie z OP taśmą?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

PAKIET 15 poz. 3 Czy Zamawiający dopuści kieszeń dwudzielną o wymiarach min 30x40 cm. Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ?


Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

PAKIET 17 Czy Zamawiający dopuści zestaw uniwersalny z poniższym składem:

- Serwety z materiału dwuwarstwowego Biflex EX, laminowanego ekstruzyjnie, o wysokiej chłonności
- Gramatura serwet 60 g/m²
- Uniwersalne zastosowanie
- Zgodność z normą PN-EN 13795 odporność na przenikanie cieczy min. 135 cm H₂O, wytrzymałość na sucho/mokro min. 200 kPa
- 4 etykiety TAG

Skład

- 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190 cm;
- 1 osłona na stolik Mayo 80 x 145 cm;
- 1 serweta z taśmą przylepną 180 x 180 cm;
- 1 serweta z taśmą przylepną 150 x 240 cm;
- 2 serwety z taśmą przylepną 75 x 100 cm;
- 2 włókninowe OP taśmy 10 x 50 cm;
- 4 ręczniki 30 x 40 cm;

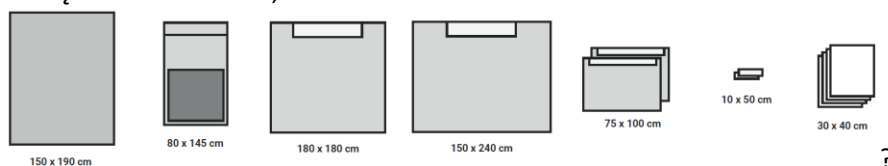

?


Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

PAKIET 18 Czy Zamawiający dopuści zestaw do cięcia cesarskiego z poniższym składem:

- Serwety z materiału dwuwarstwowego Biflex, o dużej chłonności i wysokiej odporności na przenikanie cieczy
- Serweta główna z materiału trzywarstwowego Triflex z dodatkową warstwą włókniny PP dla zwiększenia komfortu pacjenta
- Gramatura serwet 65g/m² (Biflex) i 83g/m² (Triflex)
- Zgodność z normą PN-EN 13795 odporność na przenikanie cieczy min. 135 cm H₂O, wytrzymałość na sucho/mokro min. 200 kPa
- 4 etykiety TAG

Skład

- 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190 cm;
- 1 osłona na stolik Mayo 80 x 145 cm;
- 1 serweta do owinięcia noworodka, włóknina typu Spunlance, 75 x 80 cm;
- 1 fartuch chirurgiczny wzmocniony, z włókniny typu Spunlance z nieprzemakalnymi wstawkami, rozm. XL;
- 1 serweta główna 180 x 320 cm, z przyklepnym otworem 30 x 25 cm wypełnionym folią chirurgiczną i zintegrowanym, prostokątnym zbiornikiem do przechwytywania płynów (360°). Zbiornik wyposażony w kształtki (sztywniki) oraz 2 zawory odpływowe z możliwością podłączenia do ssaka. Dodatkowo 3 zintegrowane z serwetą organizatory przewodów w formie rzepów;
- 4 ręczniki 30 x 40 cm;

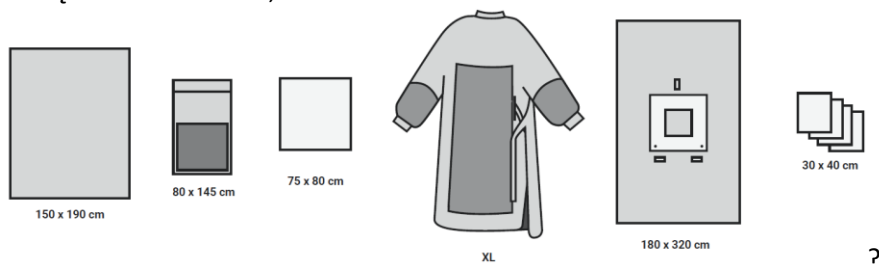

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

PAKIET 19 Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 150x200

Materiał dwuwarstwowy Biflex EX, laminowany ekstruzyjnie, o wysokiej chłonności 455ml/m²

Odporność na przenikanie cieczy min.135cmH₂O,

Wytrzymałość na wypychanie sucho/mokro – min.231kPa/225kPa

Otwór z taśmą przyklepną ułatwiającą mocowanie serwety

- Gramatura min.60g/m² (PP Spunbond Hydrofilowy 30g/m² + Folia PE 30g/m²)
- Bez przylepca
- Opakowanie papier-folia
- Trzy naklejki typu TAG
- Zgodność z normą PN-EN 13795?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

PAKIET 20 Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 75x90 z taśmą lepłą:

Materiał dwuwarstwowy Biflex EX, laminowany ekstruzyjnie, o wysokiej chłonności 455ml/m²

Odporność na przenikanie cieczy min.135cmH₂O,

Wytrzymałość na wypychanie sucho/mokro – min.231kPa/225kPa

Taśma lepna na dłuższym boku

- Gramatura min.60g/m² (PP Spunbond Hydrofilowy 30g/m² + Folia PE 30g/m²)

- Bez przylepca
- Opakowanie papier-folia
- Trzy naklejki typu TAG
- Zgodność z normą PN-EN 13795?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

PAKIET 22 Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 90x150cm z otworem o średnicy 8cm:

Materiał dwuwarstwowy Biflex EX, laminowany ekstruzyjnie, o wysokiej chłonności 455ml/m²

Odporność na przenikanie cieczy min.135cmH₂O,

Wytrzymałość na wypychanie sucho/mokro – min.231kPa/225kPa

Otwór z taśmą przylepną ułatwiającą mocowanie serwety

- Gramatura min.60g/m² (PP Spunbond Hydrofilowy 30g/m² + Folia PE 30g/m²)

- Bez przylepca
- Opakowanie papier-folia
- Trzy naklejki typu TAG
- Zgodność z normą PN-EN 13795?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

PAKIET 23 Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 150x180cm z otworem o średnicy 5x7cm:

Materiał dwuwarstwowy Biflex EX, laminowany ekstruzyjnie, o wysokiej chłonności 455ml/m²

Odporność na przenikanie cieczy min.185cmH₂O,

Wytrzymałość na wypychanie sucho/mokro – min.231kPa/225kPa

Otwór z taśmą przylepną ułatwiającą mocowanie serwety

- Gramatura min.65g/m²
- Bez przylepca
- Opakowanie papier-folia
- Trzy naklejki typu TAG
- Zgodność z normą PN-EN 13795?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

PAKIET 28 Czy Zamawiający dopuści zbiornika na płyny wykonany z nieprzemakalnej folii PE (grubość 50 mikronów), zaopatrzony w taśmę lepłą, filtr oraz sztywnik, w rozmiarze 50x50 cm, zgodny z normą PN-EN 13795?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

PAKIET 29 Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 90x150 z okrągłym otworem o średnicy 8 cm

Materiał dwuwarstwowy Biflex EX, laminowany ekstruzyjnie, o wysokiej chłonności 455ml/m²

Odporność na przenikanie cieczy min.135cmH₂O,

Wytrzymałość na wypychanie sucho/mokro – min.231kPa/225kPa

Otwór z taśmą przylepną ułatwiającą mocowanie serwety

- Gramatura min.60g/m² (PP Spunbond Hydrofilowy 30g/m² + Folia PE 30g/m²)
- Bez przylepca
- Opakowanie papier-folia
- Trzy naklejki typu TAG
- Zgodność z normą PN-EN 13795?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

PAKIET 51 Czy Zamawiający dopuści zestaw z ręcznikiem 30x40 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. W związku z tym Zamawiający zmienia zapisy Załącznika nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy w pakiecie nr 51.

Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.

PAKIET 51 Czy Zamawiający dopuści zestaw z serwetą dla noworodka w rozmiarze 80x90-100 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. W związku z tym Zamawiający zmienia zapisy Załącznika nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy w pakiecie nr 51.

Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.

PAKIET 51 Czy Zamawiający dopuści zestaw z serwetą o wymiarach 100 x 110cm, z foliowym zbiornikiem na płyny w kształcie trójkąta, wyposażonym w separator części stałych od płynnych, kształtkę (sztywnik) pozwalającą na wyprofilowanie otworu wlotowego, taśmę przylepną (2,5x60cm) oraz zawór do odprowadzania płynów?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Zamawiający informuje, że niniejszy dokument stanowi integralną część SWZ i jest wiążący dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego Zamówienia.